



پیشگامان کیفیت پاسارگاد

برنامه‌های آزمون مهارت (PT)

سال ۱۴۰۲



تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043



شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اولین مرجع برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) در ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه اعتباردهی از مرجع اعتباردهی TURKAK ترکیه و در سال ۱۳۹۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) گردید. آزمون مهارت (PT) یک ابزار مستقل برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه بوده و یک ارزیابی کاملاً محرمانه و مستقل در خصوص توانمندی آزمایشگاه ارائه می‌نماید. آزمون مهارت علاوه بر اینکه نشان‌دهنده توانایی فنی سیستم‌ها و کارکنان آزمایشگاه می‌باشد، در اخذ و نگهداری گواهینامه ISO/IEC 17025 نیز به آزمایشگاه کمک می‌کند.





پیشگامان کیفیت پاسارگاد

مراحل انجام آزمون مهارت (PT)



انتخاب برنامه موردنظر از
تقویم سالیانه



تکمیل فرم ثبت نام و ارسال
آن از طریق Email یا فکس



انجام آزمون توسط آزمایشگاه
در مهلت تعیین شده



ارسال نمونه ها به همراه
اطلاعات کاربری برای
آزمایشگاه توسط PQP




ثبت نتایج در نرم افزار PTStat
در مهلت تعیین شده



تهیه گزارش مربوط به عملکرد
آزمایشگاه ها توسط PQP

معرفی نرم افزار PTStat

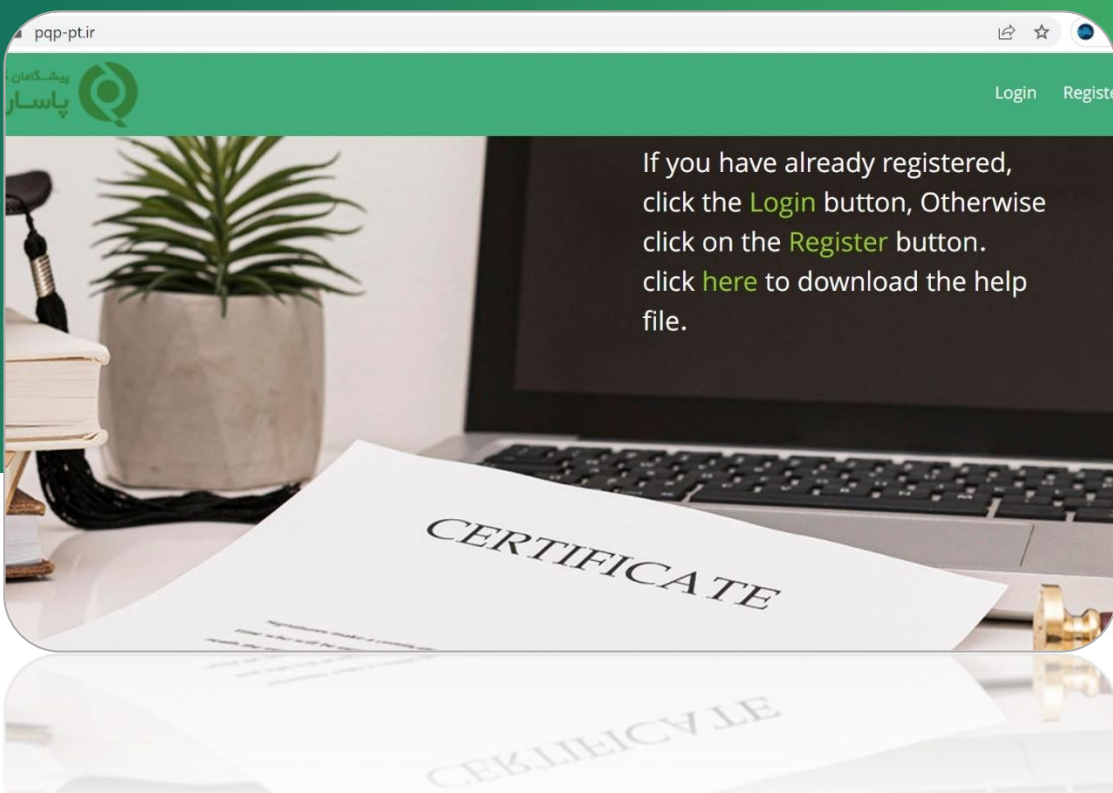

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار PTStat عنوان راه‌حلی مناسب جهت مدیریت اطلاعات برنامه‌های آزمون مهارت (PT) نموده است.

این نرم افزار دارای امکانات مختلفی به شرح زیر می‌باشد:

- ♦ امکان مشاهده گزارشات کلیه نوبت‌هایی که آزمایشگاه‌ها در آنها مشارکت داشته‌اند
- ♦ امکان دسترسی به گزارش انفرادی آزمایشگاه
- ♦ امکان دانلود گزارش نهایی برنامه
- ♦ امکان دانلود گواهینامه مشارکت یا سرآمدی
- ♦ فعالیت به دو زبان فارسی و انگلیسی به انتخاب کاربر

تقویم آزمون‌های مهارت (PT)

سال ۱۴۰۲



پیشگامان کیفیت پاسارگاد

کد برنامه	نام برنامه	تیر	مرداد	آذر	دی
WAT-CH-0032	پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب زیرزمینی				
WAT-CH-0033	پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب سطحی				
WAT-WP-0011	پارامترهای فاضلاب				
WAT-MC-0021	پارامترهای میکروبیولوژی در آب				
WAT-MC-0021-A	پارامترهای میکروبیولوژی در آب				
WAT-ST-0012	سیلیس و کدورت در آب				
WAT-MT-0012	فلزات سنگین در آب				
WAT-OH-0007	اکسوهالیدها در آب				
WAT-PES-0006	سموم در آب				
IPS-CH-0005	پارامترهای شیمیایی در آهن اسفنجی و گندله				
WAT-CL-0012	کلر باقیمانده در آب				
WAT-TM-0011	تری‌هالومتان‌ها در آب				
WAT-WM-0006	پارامترهای میکروبیولوژی در پساب				
IPS-PH-0001	پارامترهای فیزیکی گندله				

پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب زیرزمینی

WAT-CH



مرداد ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- کاتیون‌ها (۱)	کلسیم: 30-150 mg/L منیزیم: 10-50 mg/L سختی کل: 250-700 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۲- کاتیون‌ها (۲)	سدیم: 10-250 mg/L پتاسیم: 5-40 mg/L آمونیم: 0.65-19 mg/L	نمونه سنتزی	۱۰۰ میلی لیتر
نمونه ۳- EC, TDS	هدایت الکتریکی: 500- 2500 μ s/cm مجموع جامدات کل: 250-1500 mg/L	آب زیرزمینی طبیعی	۵۰۰ میلی لیتر
نمونه ۴- pH	pH: 5-10 units	نمونه سنتزی	۱۰۰ میلی لیتر
نمونه ۵- قلیائیت	قلیائیت: 10-300 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۶- آنیون‌ها (۱)	کلراید: 15-200 mg/L سولفات: 20-450 mg/L نیتрат: 20-100 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۷- آنیون‌ها (۲)	فلوراید: 0.5-2 mg/L نیتريت: 0.1-1 mg/L فسفات: 0.015-0.65 mg/L	نمونه سنتزی	۵۰ میلی لیتر

پارامترهای میکروبیولوژی در آب

WAT-MC



مرداد ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- کلی فرمها	مجموع کلی فرمها، کلی فرمهای مدفوعی و اشرشیا کلی: 20-200 CFU/100mL or MPN/100mL	ماده مرجع گواهی شده/ قرص لیوفیلیزه	۱ ویال لیوفیلیزه
نمونه ۲- باکتریهای هتروتروف	باکتریهای هتروتروف: 5-500 CFU/mL	ماده مرجع گواهی شده/ قرص لیوفیلیزه	۱ ویال لیوفیلیزه

پارامترهای میکروبیولوژی در آب (A)

WAT-MC-A



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- کلی فرمها	مجموع کلی فرمها، کلی فرمهای مدفوعی و اشرشیا کلی: 5-500 CFU/100mL or MPN/100mL	پودر لیوفیلیزه	۱ ویال لیوفیلیزه
نمونه ۲- باکتریهای هتروتروف	باکتریهای هتروتروف: 5-500 CFU/mL	پودر لیوفیلیزه	۱ ویال لیوفیلیزه
نمونه ۳: آزمون حضور- عدم حضور (Presence-Absence) کلی فرمها	Total Coliforms Positive Sample, Fecal Coliforms Positive Sample, Negative Sample	پودر لیوفیلیزه	۳ ویال لیوفیلیزه

برنامه‌های میکروبیولوژی A خارج از دامنه کاربرد (Scope) تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 قرار دارند.

فلزات سنگین در آب

WAT-MT



مرداد ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- جیوه	جیوه: $3-30 \mu\text{g/L}$	نمونه سنتزی	۱۵ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا ۵۰۰ میلی لیتر
نمونه ۲- مخلوط فلزات سنگین	آلومینیوم $25-500 \mu\text{g/L}$ آنتیموان $1-20 \mu\text{g/L}$ آرسنیک $1-25 \mu\text{g/L}$ کادمیم $1-20 \mu\text{g/L}$ کرم $5-100 \mu\text{g/L}$ کبالت $2-50 \mu\text{g/L}$ مس $200-5000 \mu\text{g/L}$ آهن $25-500 \mu\text{g/L}$ سرب $1-25 \mu\text{g/L}$ منگنز $5-100 \mu\text{g/L}$ مولیبدن $5-100 \mu\text{g/L}$ نیکل $1-25 \mu\text{g/L}$ سلنیوم $1-12 \mu\text{g/L}$ روی $100-2000 \mu\text{g/L}$	نمونه سنتزی	۵۰ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا ۱ لیتر

پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب سطحی

WAT-CH



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- کاتیون‌ها (۱)	کلسیم: 30-70 mg/L منیزیم: 0-30 mg/L سختی کل: 100-300 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۲- کاتیون‌ها (۲)	سدیم: 10-50 mg/L پتاسیم: 0-5 mg/L آمونیم: 0.65-19 mg/L	نمونه سنتزی	۱۰۰ میلی لیتر
نمونه ۳- EC, TDS	هدایت الکتریکی: 300- 700 μ S/cm مجموع جامدات کل: 150-500 mg/L	آب زیرزمینی طبیعی	۵۰۰ میلی لیتر
نمونه ۴- pH	pH: 5-10 units	نمونه سنتزی	۱۰۰ میلی لیتر
نمونه ۵- قلیائیت	قلیائیت: 10-150 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۶- آنیون‌ها (۱)	کلراید: 15-120 mg/L سولفات: 20-200 mg/L نیتрат: 0-20 mg/L	نمونه سنتزی	۲۵۰ میلی لیتر
نمونه ۷- آنیون‌ها (۲)	فلوراید: 0.25-0.5 mg/L نیتريت: 0.1-1 mg/L فسفات: 0.015-0.65 mg/L	نمونه سنتزی	۵۰ میلی لیتر

پارامترهای فاضلاب

WAT-WP



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- BOD	BOD : 50-300 mg/L	نمونه سنتزی	۱۰۰۰ میلی لیتر
نمونه ۲- COD	COD : 200-700 mg/L	نمونه سنتزی	۵۰۰ میلی لیتر
نمونه ۳- TOC	TOC : 1.3-13 mg/L	ماده مرجع گواهی شده	۱۵ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا ۵۰۰ میلی لیتر
نمونه ۴- جامدات*	Total Suspended Solids (20-100 mg/L) Total Dissolved Solids at 180°C (140-800 mg/L) Total Solids at 105°C (140-800 mg/L)	ماده مرجع گواهی شده	۵۰۰ میلی لیتر نمونه

* برنامه جامدات خارج از دامنه کاربرد (Scope) تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 قرار دارد.

سیلیس و کدورت در آب

WAT-ST



مرداد ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱: سیلیس	سیلیس: 0-20 mg/L	نمونه سنتزی	۱۰۰ میلی لیتر
نمونه ۲: کدورت	کدورت: 0.5-8 NTU	نمونه سنتزی	۲۰ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا ۵۰۰ میلی لیتر

تری‌هالومتان‌ها در آب

WAT-TM



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
تری‌هالومتان‌ها	برومو دی کلرومتان: 5-50 µg/L بروموفرم: 5-50 µg/L کلرودی برومومتان: 5-50 µg/L کلروفرم: 5-50 µg/L	ماده مرجع گواهی‌شده	۲ میلی لیتر قابل رقیق‌سازی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر

اکسوهالیدها در آب

WAT-OH



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱- برومات و بروماید	برومات: 7-50 µg/L بروماید: 50-300 µg/L	ماده مرجع گواهی شده	۲۴ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا یک لیتر
نمونه ۲- کلرات و کلریت	کلرات: 60-180 µg/L کلریت: 100-1000 µg/L	ماده مرجع گواهی شده	۲۴ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا یک لیتر

پارامترهای میکروبیولوژی فاضلاب

WAT-WM



مرداد ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
کلی فرمها	مجموع کلی فرمها، کلی فرمهای مدفوعی و اشرشیا کلی: 20-2400 CFU/100mL or MPN/100mL	ماده مرجع گواهی شده	۲ ویال لیوفیلیزه

سموم / آفت‌کش‌ها در آب / فاضلاب

WAT-PES



دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱: آفت‌کش‌های ارگانو نیتروژن	نمونه ۱: آلاکلر، آمترین، آنیلازین، آتراتون، آترازین، بروماسیل، بوتاکلر، بوتیلات، سیانازین، دی‌اتیل آترازین، دی‌ایزوپروپیل آترازین، دی آمینو آترازین، EPTC (ایتام)، هگزازینون، متولاکلر، متریبوزین، ناپروپامید، پرومتون، پرومترین، پرونامید، پروپاکلر، پروپازین، سیمازین، ترباسیل، تری فلورآلین 2-20 µg/L	ماده مرجع گواهی‌شده	۲ میلی‌لیتر قابل رقیق‌سازی تا ۱ لیتر
نمونه ۲: سموم / آفت‌کش‌های ارگانو کلره	نمونه ۲: آلدین، alpha-BHC، beta-BHC، delta-BHC، لیندان، آلفاکلردان، گاماکلردان، 4,4'-DDD، 4,4'-DDE، 4,4'-DDT، دیلدرین، اندوسولفان ۱، اندوسولفان ۲، اندوسولفان- سولفات، اندرین، اندرین آلدیاید، اندرینکتن، هپتاکلر، هپتاکلر اپکساید (بتا)، متوکسی کلر 1-20 µg/L	ماده مرجع گواهی‌شده	۲ میلی‌لیتر قابل رقیق‌سازی تا ۱ لیتر

کلر باقیمانده در آب

WAT-CL




دی ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
کلر باقیمانده	کلر باقیمانده آزاد: 0.5-3 mg/L کلر باقیمانده کل: 0.5-3 mg/L	ماده مرجع گواهی شده	۲ میلی لیتر قابل رقیق سازی تا ۱ لیتر

پارامترهای شیمیایی در آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره آهن

IPS-CH

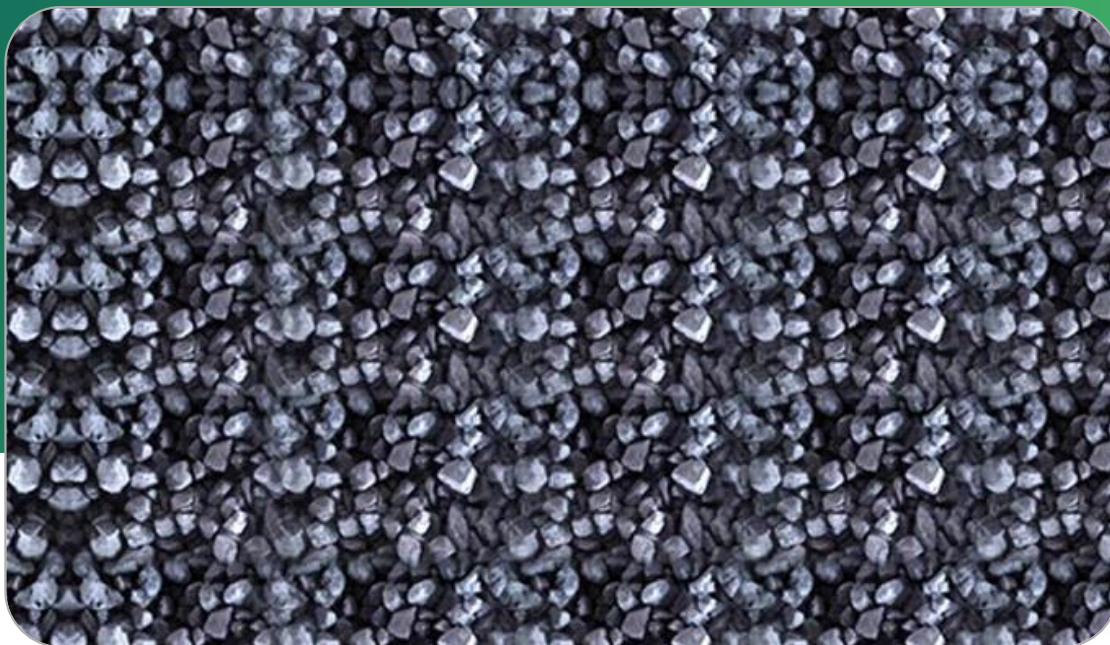

تیر ۱۴۰۲

آذر ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
نمونه ۱: آهن اسفنجی	آهن کل، آهن فلزی، کربن، گوگرد، SiO ₂ ، MnO، MgO، CaO، Al ₂ O ₃ TiO ₂ ، P ₂ O ₅ ،	آهن اسفنجی	یک بسته نمونه ۱۵ گرمی
نمونه ۲: گندله	آهن کل، FeO، گوگرد، Al ₂ O ₃ ، P ₂ O ₅ ، SiO ₂ ، MnO، MgO، CaO TiO ₂	گندله	یک بسته نمونه ۲۰ گرمی
نمونه ۳: کنسانتره آهن*	آهن کل، FeO، گوگرد، Al ₂ O ₃ ، P ₂ O ₅ ، SiO ₂ ، MnO، MgO، CaO TiO ₂	کنسانتره آهن	یک بسته نمونه ۲۰ گرمی

* برنامه کنسانتره آهن خارج از دامنه کاربرد (Scope) تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 قرار دارد.

پارامترهای فیزیکی در گندله

IPS-PH



آذر ۱۴۰۲



نام برنامه	پارامترها و محدوده مورد انتظار	نوع نمونه	حجم نمونه
پارامترهای فیزیکی در گندله	استحکام فشاری (Compressive Strength)	گندله	۶۰۰ گرم

* برنامه پارامترهای فیزیکی گندله خارج از دامنه کاربرد (Scope) تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 قرار دارد.

آزمون مهارت (PT) اختصاصی غذایی و نفتی

On-Demand PT



به درخواست مشتری

نوع نمونه	پارامترها	نام برنامه	کد برنامه
ماده مرجع گواهی شده	Trace Elements (Cd, Ca, Cl, Cu, I, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, K, Se, Na, Zn)	فلزات سنگین در پودر شیر	FOD-MP-0002
ماده مرجع گواهی شده	Ash, Calcium, Kjeldahl Nitrogen, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Starch, Total Fat	مواد مغذی اصلی در آرد گندم	FOD-FP-0002
ماده مرجع گواهی شده	Moisture, Ash, Total Fat	مواد مغذی در شیر تغلیظ شده	FOD-CM-0001
ماده مرجع گواهی شده	Nitrogen, Total Sugars	فلزات سنگین در پودر برنج	FOD-RP-0001
ماده مرجع گواهی شده	Density, Kinematic Viscosity, Flash Point, Pour Point	پارامترهای روغن روان کننده	PET-MP-0001

برنامه های آزمون مهارت اختصاصی (On-Demand) خارج از دامنه کاربرد (Scope) تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 قرار دارند.

شرکت دانش بنیان پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با بیش از ۱۵ سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از خدمات و محصولات مورد نیاز جهت اعتباردهی آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه می‌کند. این شرکت با همکاری شرکای بین‌المللی خود قصد دارد به نخستین انتخاب، قابل اعتمادترین مرجع و پیشرو در ارائه راه‌حلهایی نوآورانه به مشتریان خود تبدیل شود و با ایجاد روابط تجاری پایدار با سازمان‌های معتبر ملی و بین‌المللی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص و توانمندسازی مستمر آن‌ها، راه‌حل‌های جامع به مشتریان ارائه شده و از این طریق حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامین‌کنندگان، جامعه و دولت تامین میگردد. خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:

- ♦ خدمات مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025
 - ♦ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
 - ♦ برگزاری آزمون‌های مهارت (PT)
 - ♦ تولید و تامین مواد مرجع گواهی شده (CRMs)
- جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با PQP:

آدرس: تهران- سهروردی شمالی- خیابان
شهرتاش- پلاک ۷۴- طبقه ۳- واحد ۱۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۶۴۲۶
فاکس: ۰۲۱۸۶۰۳۰۶۲۷



info@qualitypioneers.ir



www.qualitypioneers.ir

www.pqp-pt.com

پیشگامان کیفیت
پاسارگاد در یک
نگاه

Beyond Standards



نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی
خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهرتاش
پلاک ۷۴، طبقه سوم، واحد ۱۱
تلفن: ۸۶۰۳۱۸۱۳ (۰۲۱)

.....
www.qualitypioneers.ir
www.pqp-pt.com
info@qualitypioneers.ir